Propaq® LT-Vitalfunktionsmonitor
Kurzanleitung

Neugeborene — **Von der Geburt bis zum 28. Tag bzw. bis zu einem Gestationsalter von 44 Wochen**
Kinder — **29 Tage bis 12 Jahre**
Erwachsene — **13 Jahre oder älter**

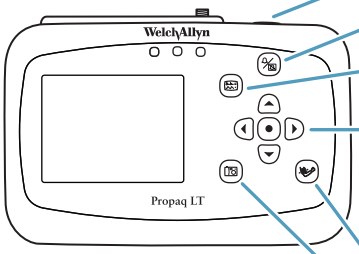

Strom ein/aus

Alarm stummschalten/rücksetzen

Anzeigeformat

Aktion für markiertes Element ausführen

Markierung nach links/rechts verschieben; Einstellungswert erhöhen/vermindern

Markierung nach oben/unten verschieben

NIBP starten/stoppen

Momentaufnahme: Für einen Zeitraum von 21 Sekunden Daten aufzeichnen

---

Alarmgrenzen ändern (HF/PF, NIBP, SpO_2, Resp) — **(Auswählen) ● (Parameter auswählen) (Grenzwerte ändern) ●**

Alarmton ändern (Leise, Mittel, Laut) — **(SpO2) ● Setup ● Alarme – Alarmton ● (Auswählen) ●**

Alarmton stummschalten/ rücksetzen

Alarmtöne aussetzen — **(HF/min) ● Setup ● Alarme – Akust. Alrm aussetz ● (Auswählen) ●**

Einstellungen (der Vitalfunktionen) ändern (HF/PF, NIBP, SpO_2, Resp) — **(Auswählen) ● (Parameter)**

Patientenmodus ändern (Erwachsene, Kinder, Neugeborene) — **Erwachsene ● (Auswählen) ●**

Ableitung ändern (I, II, III, ...) — **II ● (Auswählen)**

NIBP-Modus einstellen (Auto, Manuell, Kont) — **NIBP mmHg ● NIBP-Modus (Auswählen) ●**

Monitor-Setup ändern (Alarme, EKG, NIBP, ...) — **(NIBP) ● Setup ● (Auswählen) ● (Werte einstellen)**

Datum/Zeit ändern (Stunde, Minute, Monat, ...) — **xx:xx:xx ● (Auswählen) (Ändern) ●**

Trends anzeigen — **(NIBP) ● Trends ●**

Momentaufnahmen anzeigen — **(HF/min) ● Momentaufn ●**

Welch Allyn · Beaverton, Oregon USA
©2005 · Gedruckt in den USA · Art.-Nr.: 810-1817-00 Rev. A 12/05
800 289 2500
503 530 7500

Welch Allyn®